



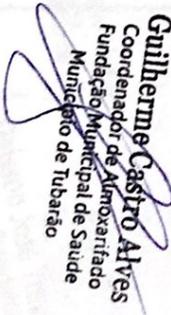
COM AMOSTRA

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCAS PRÉ APROVADAS	EMPRESAS	MARCAS COTADAS E APRESENTADAS	MOTIVO
1	<p>ALGODÃO HIDRÓFILO EMBALADO EM ROLO COM MÍNIMO DE 500 gr. Não estéril. constituído de fibras 100% algodão alvejado, isento de impurezas, macio, com boa capacidade de absorção e retenção de líquidos, embalado em rolo de no mínimo 500 gramas, com camadas sobrepostas formando uma manta com espessura uniforme entre 01 a 1,50cm e regularmente compacto, enrolado em papel apropriado em toda sua extensão, medindo no mínimo 24cm de largura. SOLICITADA AMOSTRA.</p>	Cremer	MEDEFE	NATHY	<p>REPROVADO - NÃO POSSUI CAMADA SOBREPOSTAS ENROLADO EM PAPEL APROPRIADA EM TODA SUA EXTENSÃO. NÃO POSSUI 24 CM DE LARGURA CONFORME SOLICITA O DESCRITIVO DO EDITAL. NO MATERIAL APRESENTADO, DEPOIS DE DESENROLADO O ALGODÃO, FORAM ENCONTRADOS VÁRIOS VESTÍGIOS DE IMPUREZAS, UMA PEQUENA MANCHA ESCURA, PARECIDA COM FERRUGEM NO MEIO DA CAMADA DE ALGODÃO, VESTÍGIOS DE IMPUREZAS MUITO PARECIDO COM INSETOS. PÉSSIMO CONTROLE DE QUALIDADE DA MARCA APRESENTADA.</p>

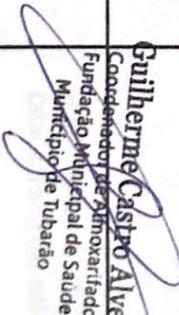

Julia Búrigo Rossi
Coordenadora de Saúde
Fundação Municipal de Saúde
Município de Tubarão/SC


Daisson José Trevisol
Diretor Presidente
Fundação Municipal de Saúde


Shirley Salvador da Luz
Eleitora
COREN 357.237/SC



Guilherme Castro Alves
Coordenador de Análises
Fundação Municipal de Saúde
Município de Tubarão


COM AMOSTRA

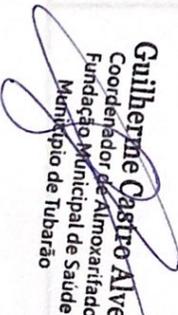
<p>2</p> <p>ATADURA DE CREPOM 04 CM. Atadura de crepom não estéril, confeccionada em 13 fios cm² nos sentidos longitudinal e transversal com a menor distância possível, medindo 04 cm de largura com 1,80 metros de comprimento desenrolada em repouso, composição de fios exigida de no mínimo 90% em algodão, com acabamento na lateral sem fios soltos, espessura e textura uniforme, apresentando elasticidade e maciez adequada a sua finalidade. Uniformemente enrolada, com bordas devidamente acabadas, isenta de falhas e lanugem, não abrasiva, moldável, absorvente, aerada, resistente aos meios de esterilização, embalada individualmente, conforme normas ABNT NBR 14.056 e acondicionada em pacote unitários. O prazo de validade mínimo deve ser de 2/3 do prazo de validade total na data de recebimento na unidade requisitante. SOLICITADA AMOSTRA</p>	<p>Cremer</p>	<p>TRADE</p>	<p>CRISTAL</p>	<p>APPROVADO - ATENDE O DESCRITIVO DO EDITAL</p> <p> Guilherme Castro Alves Coordenador de Amostrado Fundação Municipal de Saúde Município de Tubarão</p>
<p>3</p> <p>ATADURA DE CREPOM 06 CM. Atadura de crepom não estéril, confeccionada em 13 fios cm² nos sentidos longitudinal e transversal com a menor distância possível, medindo 06 cm de largura com 1,80 metros de comprimento desenrolada em repouso, composição de fios exigida de no mínimo 90% em algodão, com acabamento na lateral sem fios soltos, espessura e textura uniforme, apresentando elasticidade e maciez adequada a sua finalidade. Uniformemente enrolada, com bordas devidamente acabadas, isenta de falhas e lanugem, não abrasiva, moldável, absorvente, aerada, resistente aos meios de esterilização, embalada individualmente, conforme normas ABNT NBR 14.056 e acondicionada em pacotes unitários. O prazo de validade mínimo deve ser de 2/3 do prazo de validade total na data de recebimento na unidade requisitante. SOLICITADA AMOSTRA</p>	<p>Cremer</p>	<p>TRADE</p>	<p>BIOTEXTIL</p>	<p>APPROVADO - ATENDE O DESCRITIVO DO EDITAL</p> <p> Shailene Salvador da Luz Enfermeira COREN 357.237/SC</p> <p> Daisson José Tenório Diretor Presidente Fundação Municipal de Saúde</p>

COM AMOSTRA

<p>11</p> <p>EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL. Com conexão universal, perfeita para frascos de dieta enteral de 500 ml; controle manual de gotejamento; tubo sem memória na cor azul que permita a visualização do transito da alimentação; pinça rolete seguro com dispositivo que permita encurtar o sistema quando necessário; ponta distal com o mínimo de 6 escalas, firme e de fácil manuseio; câmara de gotejamento com o mínimo 9 ml. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. O prazo de validade mínimo deve ser de 2/3 do prazo de validade total na data de recebimento na unidade requisitante. SOLICITADA AMOSTRA</p>		MEDEFE	DESCARPACK	<p>REPROVADO - NÃO ATENDE O DESCRITIVO DO EDITAL - NÃO POSSUI PONTA ESCALONADA, NÃO POSSUI ENTRADA DE AR, NÃO POSSUI CÂMARA DE 9 ML, E NÃO POSSUI DISPOSITIVO PARA ENCURTAMENTO DE TUBO SEM FECHAR CONEXÃO DA ALIMENTAÇÃO.</p>
<p>17</p> <p>GAZE HIDRÓFILA (Bobina TIPO QUEIJO) 13 fios, confeccionada com 100% algodão, composta por três dobras e oito camadas no formato 91cmx 91m. Trazer externamente os dados de identificação conforme legislação em vigor e número de registro na ANVISA. O prazo de validade mínimo deve ser de 2/3 do prazo de validade total na data de recebimento na unidade requisitante e deve estar em conformidade com a ABNT14.108. SOLICITADA AMOSTRA</p>		SOMA	AMÉRICA	<p>APROVADO - ATENDE O DESCRITIVO DO EDITAL</p>


Daisson José Trevisol
 Diretor Presidente
 Fundação Municipal de Saúde


Mariane Salvador da Luz
 Enfermeira
 COREN 357.237 SC


Guilherme Castro Alves
 Coordenador de Almoxtarido
 Fundação Municipal de Saúde
 Município de Tubarão


Júlia Búrigo Rossi
 Coordenadora de Saúde
 Fundação Municipal de Saúde
 Município de Tubarão/SC

COM AMOSTRA

<p>20</p> <p>LUVAS DE PROCEDIMENTOS NITRÍLICA TAMANHO G (Caixa com no mínimo 100 unidades - antimicrobiana) COMPOSIÇÃO: nitrila; cor azul; boa sensibilidade tátil, antiderrapante na região digital; ambidestras; não estéril, sem talco (sem qualquer tipo de pó); descartável; palma lisa punho acabado de cano longo; adequado ao uso: salas de expurgo e desinfecção de materiais. Deve ser entregue acompanhado do CA e possuir registro no MS. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. O prazo de validade mínimo deve ser de 2/3 do prazo de validade total na data de recebimento na unidade requisitante. SOLICITADA AMOSTRA</p>	<p>AMG Medix</p>	<p>DENTAL SHOW</p>	<p>NITRAFLEX</p>	<p>REPROVADO - A LUVA DE PROCEDIMENTO APRESENTADA NÃO POSSUI TECNOLOGIA ANTIMICROBIANA COM SOLICITADO NO DESCRITIVO.</p> <p><i>Guilherme Castro Alves</i> Coordenador de Amostrado Fundação Municipal de Saúde Município de Tubarão</p>
<p>22</p> <p>LUVAS DE PROCEDIMENTOS NITRÍLICA TAMANHO M (Caixa com no mínimo 100 unidades - antimicrobiana) COMPOSIÇÃO: nitrila; cor azul; boa sensibilidade tátil, antiderrapante na região digital; ambidestras; não estéril, sem talco (sem qualquer tipo de pó); descartável; palma lisa punho acabado de cano longo; adequado ao uso: salas de expurgo e desinfecção de materiais. Deve ser entregue acompanhado do CA e possuir registro no MS. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. O prazo de validade mínimo deve ser de 2/3 do prazo de validade total na data de recebimento na unidade requisitante. SOLICITADA AMOSTRA</p>	<p>AMG Medix</p>	<p>DENTAL SHOW</p>	<p>NITRAFLEX</p>	<p>REPROVADO - A LUVA DE PROCEDIMENTO APRESENTADA NÃO POSSUI TECNOLOGIA ANTIMICROBIANA COM SOLICITADO NO DESCRITIVO.</p>

Julia Brito Rossi
Coordenadora de Saúde
Fundação Municipal de Saúde
Município de Tubarão/SC

Daisson José Trevisol
Diretor Presidente
Fundação Municipal de Saúde

Vanilde Silveira da Luz
Enfermeira
COREN 357.237 SC

COM AMOSTRA

<p>23</p> <p>LUVAS DE PROCEDIMENTOS NITRILICA TAMANHO P (Caixa com no mínimo 100 unidades - antimicrobiana) COMPOSIÇÃO: nitríla; cor azul; boa sensibilidade tátil, antiderrapante na região digital; ambidestras; não estéril, sem talco (sem qualquer tipo de pó); descartável; palma lisa punho acabado de cano longo; adequado ao uso: salas de expurgo e desinfecção de materiais. Deve ser entregue acompanhado do CA e possuir registro no MS. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. O prazo de validade mínimo deve ser de 2/3 do prazo de validade total na data de recebimento na unidade requisitante. SOLICITADA AMOSTRA</p>	<p>AMG Medix</p>	<p>DENTAL SHOW</p>	<p>NITRAFLEX</p>	<p>REPROVADO - NÃO ENVIOU AMOSTRA.</p> <p><i>Guilherme Castro Alves</i> Coordenador de Amparo Fundação Municipal de Saúde Município de Tubarão</p>
<p>24</p> <p>LUVAS DE PROCEDIMENTOS NITRILICA TAMANHO PP (Caixa com no mínimo 100 unidades - antimicrobiana) COMPOSIÇÃO: nitríla; cor azul; boa sensibilidade tátil, antiderrapante na região digital; ambidestras; não estéril, sem talco (sem qualquer tipo de pó); descartável; palma lisa punho acabado de cano longo; adequado ao uso: salas de expurgo e desinfecção de materiais. Deve ser entregue acompanhado do CA e possuir registro no MS. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no MS. O prazo de validade mínimo deve ser de 2/3 do prazo de validade total na data de recebimento na unidade requisitante. SOLICITADA AMOSTRA</p>	<p>AMG Medix</p>	<p>ISAMED</p>	<p>MEDIX</p>	<p>REPROVADO - NÃO ENVIOU AMOSTRA.</p>

Juliana Búrigo Rossi
Búrgia de Saúde
Coordenadora de Saúde
Fundação Municipal de Saúde
Município de Tubarão/SC

Daiisson José Trevisol
Diretor Presidente
Fundação Municipal de Saúde

Shirley Salvador da Luz
Enfermeira
COREN 357.237/SC

COM AMOSTRA

<p>25</p> <p>SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML SEM AGULHA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA: Seringa descartável 1 ml, estéril, s/ agulha, c/ rosca, com capacidade para 1 ml, confeccionada em polipropileno, fabricada e embalada em conformidade com a NBR Nº 9752/87 e legislação sanitária vigente, composta por cilindro, embolo. O dispositivo de segurança deverá garantir total impossibilidade de contato com a agulha e seu conteúdo biológico, bem como estar em conformidade com a NR32 do M.T.E. Apresentar escala graduada em ml, com volume total de 1 ml, graduação com intervalo 0,1 em 0,1 com subdivisão 0,01 ml. Bico Luer lock, capaz de garantir conexões seguras e sem vazamentos a canhões de agulhas. Com embolo confeccionado em plástico; com haste e base de apoio, moldadas de maneira a facilitar a aspiração e injeção de fluidos Com pistão confeccionado em borracha, devidamente fixado na parte proximal da haste, em formato capaz de favorecer e facilitar a perfeita visualização da dosagem e evitar vazamento do líquido/fluido, alem de assegurar perfeito e suave deslizamento em todo o cilindro. Na entrega do produto o prazo de validade não poderá exceder mais de dois terços do prazo total. SOLICITADA AMOSTRA.</p>	<p>BD</p>	<p>PRODUVALE</p>	<p>SOL-MILLENNIUM C</p>	<p>REPROVADO - NÃO ATENDE O DESCRITIVO DO EDITAL.</p> <p>Guilherme Castro Alves Coordenador de Amostrado Fundação Municipal de Saúde Município de Tubarão</p>
--	-----------	------------------	-------------------------	--



Júlia Burigo Rossi
Coordenadora de Saúde
Fundação Municipal de Saúde
Município de Tubarão/SC



Daisson José Trevisol
Diretor Presidente
Fundação Municipal de Saúde


Marilene Salvador da Luz
Enfermeira
COREN 357.237/SC

COM AMOSTRA

<p>26</p>	<p>SERINGA DESCARTÁVEL 12,7x0,3, cap t-100 insulina, com agulha (det.) sem dispositivo de segurança. Seringa descartável de polipropileno, sem dispositivo segurança bico universal, corpo translúcido, silicizada internamente, graduação exata e resistente, capacidade T - 100 insulina, com agulha aproximadamente 12,7x0,3, estéril embalagem unitária, registro no MS. SOLICITADA AMOSTRA</p>	<p>BD</p>	<p>ALTERMED</p>	<p>SR</p>	<p>REPROVADO - POSSUI O SEU TRIFACETADO MAL ACABADO E TRAUMÁTICO, CAUSANDO MUITAS DORES NOS PACIENTES, CONFORME RELATADO PELOS MESMOS. A AMOSTRA ENVIADA APRESENTAVA FIAPÓS DE PLÁSTICO, DEMONSTRANDO MAU ACABAMENTO. SUA GRADUAÇÃO FOI ANALISADA E NÃO É EXATA COMPARADO COM OUTRAS AMOSTRAS E SAEM COM FACILIDADE. NÃO ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS DA RDC N° 24 DE 05 DE MAIO DE 2014.</p>
-----------	---	-----------	-----------------	-----------	---


Guilherme Castro Alves
 Coordenador de Almoxarifado
 Fundação Municipal de Saúde
 Município de Tubarão


Waisson José Trevisol
 Diretor Presidente
 Fundação Municipal de Saúde


Silviane Salvador da Luz
 Enfermeira
 COREN 357 237 SC


Julia Brito Rossi
 Coordenadora de Saúde
 Fundação Municipal de Saúde
 Município de Tubarão/SC

COM AMOSTRA

<p>30</p> <p>SERINGA DESCARTÁVEL 6X0.25, cap t- 100 insulina, com agulha (det.) sem dispositivo de segurança. Seringa descartável de polipropileno, sem dispositivo segurança bico universal, corpo translúcido, silconizada internamente, graduação exata e resistente, capacidade T - 100 insulina, com agulha aproximadamente 6X0.25, estéril embalagem unitária, registro no MS. SOLICITADA AMOSTRA</p>	<p>BD</p>	<p>ALTERMED</p>	<p>SR</p>	<p>REPROVADO - POSSUI O SEU TRIFACETADO MAL ACABADO E TRAUMÁTICO, CAUSANDO MUITAS DORES NOS PACIENTES, CONFORME RELATADO PELOS MESMOS. A AMOSTRA ENVIADA APRESENTAVA FIAPÓS DE PLÁSTICO, DEMONSTRANDO MAU ACABAMENTO. SUA GRADUAÇÃO FOI ANALISADA E NÃO É EXATA COMPARADO COM OUTRAS AMOSTRAS E SAEM COM FACILIDADE. NÃO ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS DA RDC N° 24 DE 05 DE MAIO DE 2014</p>
---	-----------	-----------------	-----------	--

Guilherme Castro Alves
 Coordenador de Almoxtarido
 Fundação Municipal de Saúde
 Município de Tubarão

Daiisson José Trevisol
 Diretor Presidente
 Fundação Municipal de Saúde

Shaiane Salvador da Luz
 Enfermeira
 COPEN 857.237 SC

Julia Bastigo Rossi
 Coordenadora de Saúde
 Fundação Municipal de Saúde
 Município de Tubarão/SC